

## Protocolo

**Ensayo de aptitud para la calibración de  
generadores multifunciones, en 5 propiedades  
medibles eléctricas.**

Metrología Eléctrica  
Dirección de Mediciones Electromagnéticas

## ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN .....	3
2.	OBJETIVO Y ALCANCE .....	3
3.	MENSURANDO.....	4
4.	CONTACTO CENAM .....	4
5.	REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.....	4
5.1.	Aceptación del protocolo .....	5
6.	ORGANIZACIÓN .....	5
6.1.	Descripción del ensayo .....	5
6.2.	Ítem de ensayo.....	6
6.3.	Valor de referencia y su estabilidad.....	6
6.4.	Transporte del ítem de ensayo .....	6
6.5.	Casos en los que se utiliza mensajería.....	8
7.	INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE MEDICIONES .....	8
7.1.	Antes de iniciar las mediciones.....	8
7.2.	Durante las mediciones .....	9
8.	RESULTADOS.....	10
8.1.	Criterio de evaluación de resultados .....	11
ANEXO I.	DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN.....	12
ANEXO II.	FORMATO DE CAMBIO DE CUSTODIA .....	13
ANEXO III.	FORMATO DE RESULTADOS.....	14
ANEXO IV.	ACCESO AL SISTEMA INFORMÁTICO DE ENSAYOS DE APTITUD.....	16

## 1. INTRODUCCIÓN

El propósito de los ensayos de aptitud es determinar la competencia técnica de los laboratorios, en los servicios que ofrecen, por medio de comparaciones. La participación en programas de ensayos de aptitud provee a los laboratorios de un método objetivo para evaluar y demostrar la confiabilidad de los datos que producen.

Este ensayo de aptitud se diseñó de acuerdo con los lineamientos de la norma ISO/IEC 17043:2023 Conformity assessment-General requirements for the competence of proficiency testing providers.

## 2. OBJETIVO Y ALCANCE

Este ensayo de aptitud tiene como objetivo evaluar la competencia técnica del laboratorio participante en la realización de servicios de calibración a generadores multifunciones en propiedades medibles eléctricas.

Este ensayo de aptitud sólo considera la evaluación de los resultados de calibración del laboratorio participante en la propiedad medible y puntos de medición indicados en la tabla I. No se evalúa ninguna otra característica técnica o administrativa.

**Tabla I.** Puntos de medición del ensayo de aptitud

Propiedad medible eléctrica	Puntos de medición
Tensión eléctrica continua	100 mV, 1 V, 1000 V
Tensión eléctrica alterna	100 mV/ 50 Hz, 1 V / 100 kHz 120 V/ 50 Hz y 700 V /1 kHz
Resistencia eléctrica	10 kΩ y 100 MΩ
Corriente eléctrica continua	100 µA y 10 A
Corriente eléctrica alterna	1 A / 50 Hz, 1 A / 1 kHz, 10 A / 50 Hz y 10 A/ 1 kHz

### 3. MENSURANDO

El mensurando es el error relativo, evaluado de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\text{Error relativo} = \frac{\text{Valor indicado} - \text{Valor de referencia}}{\text{Valor de referencia}}$$

Donde:

Valor indicado Es la indicación configurada en el ítem de ensayo

Valor de referencia Es el mejor estimado del participante, utilizado como valor de referencia para realizar las calibraciones

### 4. CONTACTO CENAM

#### Contacto técnico

Sara Campos [scampos@cenam.mx](mailto:scampos@cenam.mx)

Eduardo Gutiérrez [egutierrez@cenam.mx](mailto:egutierrez@cenam.mx)

#### Contacto administrativo CENAM

Maribel Medina [mmedina@cenam.mx](mailto:mmedina@cenam.mx)

Luis Alejandro Garibay Cordero [lgaribay@cenam.mx](mailto:lgaribay@cenam.mx)

### 5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

El ensayo de aptitud está orientado a laboratorios de calibración que ofrezcan servicios de calibración a generadores multifunción, en propiedades medibles eléctricas, cuyo sistema de calidad esté basado en la norma NMX-EC-17025-IMNC vigente. Antes de iniciar el ensayo el participante deberá enviar al contacto técnico CENAM la siguiente información:

- a) Copia del informe de calibración del patrón que utilizará para realizar las mediciones.
- b) Evidencia de capacitación en técnicas de medición de propiedades medibles eléctricas y estimación de incertidumbre.
- c) Copia de las Capacidades de Medición y Calibración (CMCs) acreditadas, para la calibración de generadores multifunción, en propiedades medibles eléctricas. Si se trata de un laboratorio no acreditado o en proceso de acreditación, deberá enviar las CMCS soportadas por su sistema de calidad.

Los participantes que ya han participado en años anteriores en este ensayo de aptitud con el CENAM deberán enviar solamente la información del punto a). En el caso en que sus CMCS estén en proceso de cambio, deberán enviar la información que van a modificar.

---

Protocolo: Ensayo de aptitud para la calibración de generadores multifunciones, en 5 propiedades medibles eléctricas.

*Derechos reservados CENAM*

### 5.1. Aceptación del protocolo

El representante legal del laboratorio deberá firmar la aceptación de los términos de referencia contenidos en este protocolo (Anexo I. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN). El documento deberá enviarse al contacto técnico del CENAM **una semana antes del inicio del ensayo**. En caso de no enviarse en la fecha prevista el laboratorio no podrá participar en este ensayo de aptitud.

## 6. ORGANIZACIÓN

### 6.1. Descripción del ensayo

El ítem de ensayo será calibrado por el CENAM al inicio y al término del ensayo de aptitud.

Participan máximo 5 laboratorios, cada participante contará con una semana como máximo para realizar mediciones. Este tiempo incluye la recepción del ítem de ensayo y la entrega de éste al siguiente participante. Al término de sus mediciones contará con una semana para registrar sus resultados.

Una vez recibido el informe del último participante, el CENAM analizará los resultados y emitirá el informe, la fecha de entrega de éste puede consultarse en la siguiente liga:

<https://www.cenam.mx/servicios/paptitudtecnica/ensayos.aspx?id=410#listaprogramados>

En la siguiente figura se presenta un ejemplo de la información mostrada en el sitio.

Clave	Fecha límite de inscripción	Fecha de envío de protocolo	Fecha de inicio del ensayo	Fecha de entrega del informe final por parte del CENAM
CNM-EA-410-0006/2025	2025-08-12	2025-06-02	2025-06-16	2025-09-22

**Figura 1.** Ejemplo de la información mostrada en el sitio de ensayos de ensayo de aptitud.

Una vez que el participante registre su inscripción y reciba el protocolo se le hará saber su fecha de participación y fecha de entrega de resultados.

---

Protocolo: Ensayo de aptitud para la calibración de generadores multifunciones, en 5 propiedades medibles eléctricas.

*Derechos reservados CENAM*

## 6.2. Ítem de ensayo

Se utilizará como ítem de ensayo un calibrador multifunciones de mediana exactitud. Este instrumento de medición se utiliza para discriminar las componentes de incertidumbre asociadas con las capacidades de medición propias del laboratorio participante respecto de las componentes de incertidumbre propias de este patrón de referencia. El ítem de ensayo se describe en la tabla II.

**Tabla II. Descripción del ítem de ensayo**

Ítem de ensayo	
Descripción:	Calibrador multifunciones de mediana exactitud
Marca:	XXXX
Modelo:	XXXX

## 6.3. Valor de referencia y su estabilidad

Los valores de referencia serán los determinados por el CENAM. Para determinar el valor de referencia el CENAM realiza una aproximación lineal, a partir del historial de valores del ítem de ensayo y de los valores de calibración del CENAM antes y después de las mediciones de los participantes. La incertidumbre asociada al ajuste lineal se incluye como contribución de incertidumbre por estabilidad del ítem de ensayo.<sup>1</sup>

## 6.4. Transporte del ítem de ensayo

**El primer participante deberá acudir a las instalaciones del CENAM para la recepción del ítem de ensayo. El resto de los participantes deberán recibir personalmente el ítem de ensayo en las instalaciones del participante anterior, de acuerdo con la información proporcionada por el CENAM.**

**El último participante deberá entregar el ítem de ensayo en las instalaciones del CENAM.**

El horario de entrega y recepción del ítem de ensayo debe ser acordado por correo electrónico entre los laboratorios involucrados, con copia para el contacto técnico CENAM, uno o dos días antes de su participación.

---

<sup>1</sup> Mary. G. Natrella. Experimental Statistics. Handbook 91. United States Department of Commerce. NIST

Una vez que el ensayo de aptitud dé inicio, el contacto técnico del CENAM supervisará la circulación del ítem de ensayo en tiempo y forma. El mismo día de la entrega del ítem de ensayo, el laboratorio que entrega es responsable de enviar al contacto técnico de CENAM el FORMATO DE CAMBIO DE CUSTODIA (Anexo II).

En la siguiente figura se muestra el empaque del ítem de ensayo, así como sus dimensiones



Es importante considerar las dimensiones de la caja para:

- Utilizar un vehículo de dimensiones adecuadas para su transporte
- Llenar la guía de envío, cuando se utilice mensajería.

Dimensiones: (85 x 72 x 45) cm

Peso aproximado: 42 kg

**Figura 2:** Ítem de ensayo y su maleta de empaque

*\*Espacio intencionalmente en blanco\**

Protocolo: Ensayo de aptitud para la calibración de generadores multifunciones, en 5 propiedades medibles eléctricas.

**Derechos reservados CENAM**

## 6.5. Casos en los que se utiliza mensajería

El servicio de mensajería solo podrá utilizarse cuando la distancia entre laboratorios participantes sea considerable, previo acuerdo con el contacto técnico de CENAM. El servicio de mensajería deberá contar con compromiso de tiempo de entrega al día siguiente.

Cuando se utilice mensajería el laboratorio que envía el equipo deberá:

- Tomar fotos y un pequeño video del equipo operando
- Empacar el equipo en las mismas condiciones en las que se recibió
- Revisar que el display quede del lado de la manija, que es la parte superior de la maleta, cuando se arrastra.
- Tomar fotos del empaque cerrado, del empaque abierto y del estado general del equipo.

Estos registros deberán enviarse por correo electrónico al participante que recibe el equipo y al contacto CENAM.

## 7. INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE MEDICIONES

El ítem de ensayo debe ser manejado únicamente por personal autorizado en el laboratorio con el fin de evitar cualquier tipo de daño.

Al ingreso a cada laboratorio el participante deberá revisar de forma visual que el ítem de ensayo no haya sufrido ningún percance, de notar algún desperfecto visual, deberá notificarlo de manera inmediata al contacto técnico del CENAM.

### 7.1. Antes de iniciar las mediciones

El ítem de ensayo deberá energizarse a una línea de alimentación de  $120\text{ V} \pm 10\%$  y frecuencia de 60 Hz. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, conecte el cable de alimentación de tres conductores, que se envía junto con el patrón viajero, a una toma de corriente con conexión a tierra. No utilice un adaptador de dos conductores, esto cancela la conexión a tierra de protección.

Al energizar el ítem de ensayo aparecerá el mensaje "Starting up" y se completará una rutina de auto-prueba. Si la auto-prueba falla, la pantalla de control indicará un código de error. El participante deberá notificarlo de manera inmediata al contacto técnico CENAM.

Si durante su transporte o en las instalaciones del participante el ítem de ensayo presentara alguna falla operacional, será responsabilidad del participante cubrir los gastos de reparación o reposición del ítem de ensayo al CENAM (Ver anexo I).


## 7.2. Durante las mediciones

El ítem de ensayo deberá permanecer energizado la semana de las mediciones y **deberá estabilizarse energizado por un tiempo mínimo de cuatro horas, antes de realizar el ZERO y las mediciones.**

Se deberán utilizar únicamente las terminales del panel frontal del ítem de ensayo.

Antes de iniciar las mediciones, se deberá ejecutar la función ZERO. Esta función se debe ejecutar de la siguiente manera:

- **Desconectar todos los cables del panel frontal del patrón viajero**
- Digitar la secuencia de teclas:

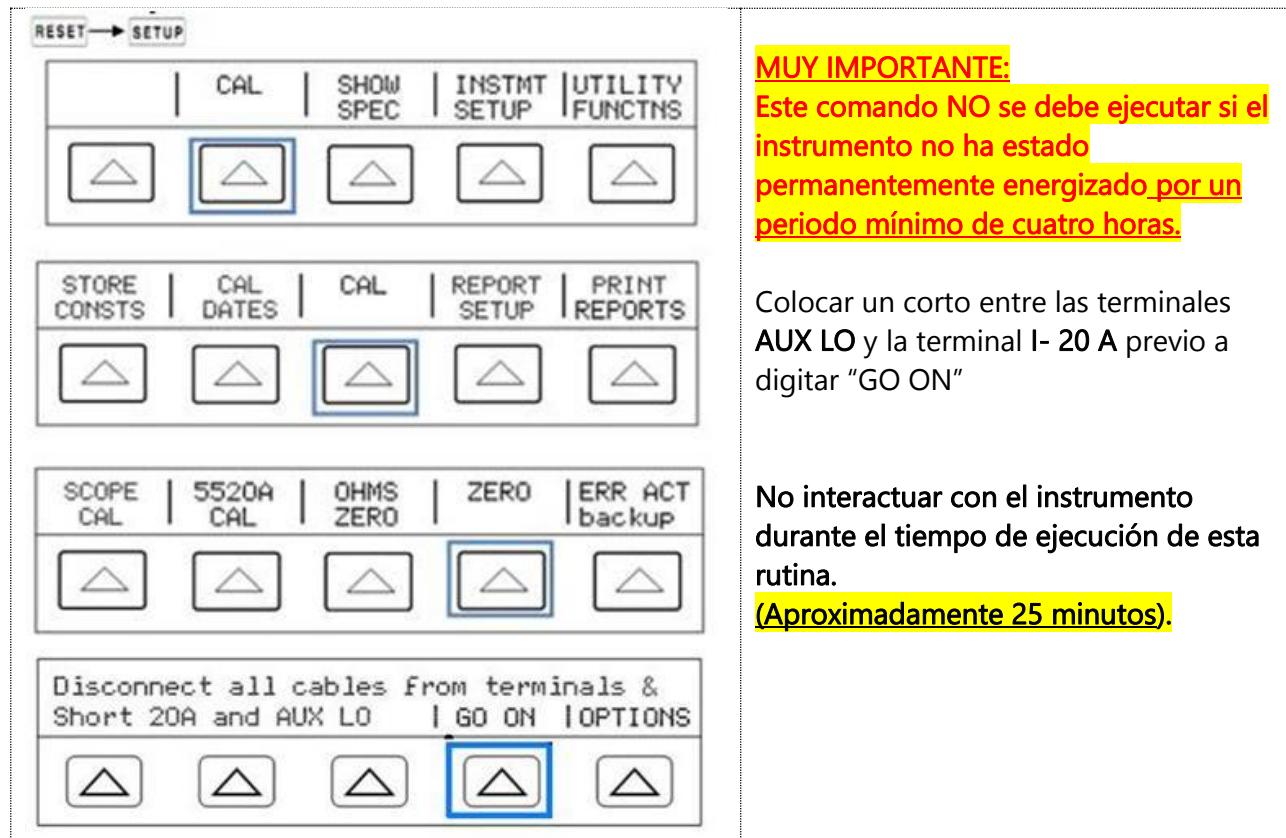

El laboratorio deberá utilizar los procedimientos de medición de su laboratorio, aplicables para la calibración de generadores en las diferentes propiedades medibles eléctricas, utilizando el patrón de referencia con el cual tiene declarada la trazabilidad de sus mediciones.

Las condiciones de medición del laboratorio, de acuerdo con su sistema de calidad, deberán satisfacer los requerimientos de su patrón de referencia y de los instrumentos que cotidianamente calibra. Estas condiciones de medición deberán registrarse durante la semana de mediciones e incluirse en el informe.

## 8. RESULTADOS

Una semana después de haber concluido sus mediciones, el participante deberá subir al sitio de ensayos de aptitud (Ver anexo IV) la siguiente información:

- Los resultados en el formato en el que cotidianamente entrega un informe de calibración a sus clientes. Indicando como cliente que se trata de un ensayo de aptitud, con el nombre: Código del ensayo de aptitud.

**NO INDICAR QUE EL CLIENTE ES EL CENAM, EL CENAM ES EL PROVEEDOR DEL ENSAYO DE APTITUD, EL CLIENTE ES EL PARTICIPANTE.**

- La información solicitada en el Anexo III de este documento
- Para las mediciones de corriente eléctrica continua y alterna ( 1 A y 10 A) el tiempo de estabilización debe ser de 5 minutos antes de tomar mediciones.

Si el laboratorio no entrega sus resultados en la fecha establecida, se considerará que ha abandonado el ensayo de aptitud.

*\*Espacio intencionalmente en blanco\**

### 8.1. Criterio de evaluación de resultados

El criterio de evaluación es el error normalizado:

$$E_n = \frac{E_i - E_{\text{CENAM}}}{\sqrt{U_i^2 + U_{\text{CENAM}}^2}}$$

Donde:

$E_i$  Es el error relativo reportado por el participante, por punto de calibración.

$E_{\text{CENAM}}$  Es el error relativo evaluado por el CENAM, por punto de calibración.

$U_i$  Es la incertidumbre expandida reportada por el participante, en su informe de calibración, para un nivel de confianza del 95.45 %.

$U_{\text{CENAM}}$  Es la incertidumbre expandida reportada por el CENAM para un nivel de confianza del 95.45 %

Valores de  $|E_n| > 1$  indican resultados no satisfactorios.

Valores de  $|E_n| \leq 1$  indican resultados satisfactorios.

Para que el resultado del error normalizado sea válido, la incertidumbre reportada por el participante debe ser acorde con sus Capacidades de Medición y Calibración (CMC), por esta razón es un requisito de participación contar con las CMCs del participante antes del inicio del ensayo de aptitud.

Se analizará la concordancia entre los valores de incertidumbre reportados en el informe ( $U_i$ ), en relación con los valores de incertidumbre declarados en la CMCs ( $U_{\text{CMC}}$ ) del participante.

Es importante señalar que en una calibración es posible obtener valores de incertidumbre un poco mayores a los declarados en las tablas de CMCs. Para la revisión de la concordancia con las CMCs se revisará que la incertidumbre declarada en el informe esté dentro del intervalo de incertidumbre declarado en la tabla CMC, que la incertidumbre declarada corresponda con el presupuesto de incertidumbre enviado, que estén consideradas todas las contribuciones de incertidumbre y que estén bien estimadas.

*\*Espacio intencionalmente en blanco\**

## ANEXO I. DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN

Doy mi consentimiento para que la información que proporcioné en la inscripción (datos del contacto técnico y dirección del laboratorio) se comparta con los participantes de este ensayo de aptitud para la logística de recepción y entrega del ítem de ensayo.

Acepto los términos de referencia contenidos en este protocolo. Así mismo me comprometo a cubrir los gastos de reparación o reposición del ítem de ensayo al CENAM, en el caso de que éste sufra algún daño durante su traslado a las instalaciones de mi laboratorio o dentro de las instalaciones de mi laboratorio.

Nombre del laboratorio:

---

Representante legal del laboratorio:

Fecha y Firma:

---

**Nota 1:** Para evitar que los correos que reciba del Centro Nacional de Metrología sean enviados a la carpeta de "Correo no deseado (SPAM)", se le solicita amablemente que agregue el dominio @cenam.mx a la lista de remitentes seguros.

**Nota 2:** Se solicita al participante tener presente las fechas de descarga del protocolo y del informe de resultados, las cuales le serán notificadas por el CENAM.

*\*Espacio intencionalmente en blanco\**

**ANEXO II. FORMATO DE CAMBIO DE CUSTODIA**  
(Formato de recepción y entrega del ítem de ensayo)

**EL LABORATORIO QUE ENTREGA EL EQUIPO DEBERÁ LLENAR Y ENVIAR ESTE FORMATO  
POR CORREO ELECTRÓNICO AL CONTACTO TÉCNICO CENAM.**

**Descripción:** Calibrador multifunciones

**Marca:** \_\_\_\_\_

**Modelo:** \_\_\_\_\_

**Número de serie:** \_\_\_\_\_

Antes de empacar el equipo, energice el ítem de ensayo en presencia del participante que recibe el equipo. Revise que la prueba de "starting-up" se ejecute adecuadamente sin indicar falla.

El resultado fue:

Sin notificación de falla

Notificación de falla

Notifico que he entregado el equipo descrito en condiciones adecuadas y empacado adecuadamente.

Entregado por: \_\_\_\_\_ Laboratorio participante: \_\_\_\_\_ Firma y Fecha: \_\_\_\_\_

Observaciones:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Notifico que recibo el equipo descrito, operando adecuadamente:

Recibido por: \_\_\_\_\_ Laboratorio participante: \_\_\_\_\_ Firma y Fecha: \_\_\_\_\_

**NOTA:** Los laboratorios que previo acuerdo con el contacto técnico CENAM, usan mensajería deberán enviar video y fotografías del equipo operando antes de su empaque y empacado antes de su envío (VER PUNTO 6.5)

---

Protocolo: Ensayo de aptitud para la calibración de generadores multifunciones, en 5 propiedades medibles eléctricas.

*Derechos reservados CENAM*

**ANEXO III. FORMATO DE RESULTADOS**  
(Adicional al informe de calibración)

Laboratorio participante:

Fechas de medición:

Punto de medición	Valor de referencia	Valor indicado por el ítem de ensayo	Error relativo	Incertidumbre expandida	Incertidumbre declarada en su tabla de CMCs
100 mV					
1 V					
1000 V					
100 mV / 50 Hz					
1 V / 100 kHz					
120 V / 50 Hz					
700 V / 1 kHz					
10 kΩ					
100 MΩ					
100 µA					
10 A					
1 A / 50 Hz					
1 A / 1 kHz					
10 A / 50 Hz					
10 A / 1 kHz					

El participante deberá indicar las contribuciones de incertidumbre que considera para determinar la incertidumbre asociada al resultado de sus mediciones, podrá incluir más o menos columnas que las indicadas en la siguiente tabla.

El participante deberá indicar cuál es la contribución de incertidumbre, por ejemplo, resolución, estabilidad, etc, así como el valor de éstas.

Punto de medición:	Contribuciones de Incertidumbre				Incertidumbre combinada
100 mV					
1 V					
1000 V					
100 mV / 50 Hz					
1 V / 100 kHz					
120 V / 50 Hz					
700 V / 1 kHz					
10 kΩ					
100 MΩ					
100 µA					
10 A					
1 A / 50 Hz					
1 A / 1 kHz					
10 A / 50 Hz					
10 A / 1 kHz					

#### ANEXO IV. ACCESO AL SISTEMA INFORMÁTICO DE ENSAYOS DE APTITUD

Una vez confirmado su pago y llegada la fecha de envío del protocolo recibirá en la cuenta de correo electrónico que usted haya registrado al momento de su inscripción un mensaje como el siguiente:

CENTRO NACIONAL DE METROLOGÍA

POR FAVOR NO CONTESTE ESTE MENSAJE CON "Responder"  
EL ENVÍO LO REALIZA UNA CUENTA AUTOMÁTICA.

Estimado(a) participante: XXXXXXXXX

El enlace lo llevará a un sitio donde podrá descargar su protocolo para del ensayo de aptitud "*Ensayo de aptitud para la Calibración de XXXXX . (CNM-EA-410-XXX/20XX)*".

[Descarga de protocolo](#)

Código de participación: XXXXX

Observaciones: Sin observaciones

Para cualquier duda o aclaración haga [clic aquí](#).

El enlace que recibió le permitirá:

- Conocer su código de participación
- Descargar el protocolo.
- Subir sus resultados.
- Descargar el informe del Ensayo de Aptitud.

El enlace es permanente, por lo que podrá acceder tantas veces como lo necesite.

Por favor considere que los enlaces se activarán hasta la fecha indicada por CENAM.

*\*Espacio intencionalmente en blanco\**

---

Protocolo: Ensayo de aptitud para la calibración de generadores multifunciones, en 5 propiedades medibles eléctricas.

**Derechos reservados CENAM**

## ENVÍO DE SUS RESULTADOS A CENAM

Al llegar la fecha para el envío de sus resultados, usted deberá ingresar al mismo vínculo donde descargó el protocolo y ubicar la pestaña “**Resultados**”. Para poder subir sus resultados deberá registrar primero el archivo de **cambio de custodia**. (Anexo II)



The screenshot shows a user interface for uploading results. At the top, there are three tabs: "Protocolo" (selected), "Resultados", and "Informe". Below the tabs, a note in green text reads: "Para registrar sus resultados deberá primero subir el archivo de cambio de custodia." To the right of this note is a file selection input field with the placeholder "Seleccionar archivo" and the status "Ningún archivo seleccionado". At the top right of the interface is a small icon of a document with a pencil and the text "Si tiene alguna duda o aclaración haga clic aquí".

El sistema le permite subir un solo archivo, si requiere enviar varios, éstos deben ser remitidos en un archivo comprimido.

Es muy importante que usted suba sus archivos en el día programado, de no recibir sus resultados oportunamente se considerará como ABANDONADO el ensayo de Aptitud.

## DESCARGA DEL INFORME FINAL

En la fecha indicada por CENAM, usted deberá ingresar al sitio del participante para descargar el informe final del Ensayo de Aptitud.

**Por favor considere que el vínculo donde se le indica su clave de participación y acceso al sitio para registrar o descargar resultados, únicamente es enviado a la cuenta de correo electrónico que se registró en la inscripción.**

*“FIN DEL DOCUMENTO”*

---

Protocolo: Ensayo de aptitud para la calibración de generadores multifunciones, en 5 propiedades medibles eléctricas.

*Derechos reservados CENAM*